GE Healthcare

アドバンスドブリージングシステム（ABS）

オートクレーブ滅菌を行うための装置の分解方法

1

換気システムのバッグホースを外してください。

標準カニスタの場合は、カニスタを持ち、カニスタ留めを押して、ロック解除してください。

EZchange カニスタの場合は、カニスタを持ち、カニスタケースのリリースラッチを押して、カニスタのロックを解除してください。

カニスタを外してください。

2

EZchange カニスタモジュールまたはコンデンサが取り付けられている場合は、モジュールのリリースラッチを押し、ユニットを引き下げて、モジュールを外してください。

3

Bag/Vent のスイッチを Vent に設定します。

リリースボタンを押し、ラッチのハンドルをゆっくり引いてください。

背面のハンドルを持って換気システムを支えながら、ラッチのハンドルを引いて、換気システムをワークステーションから離すように、滑らせてください。

4

フローセンサーのラッチを引いて、モジュールを外してください。

O_2 センサーがある場合は、反時計回りに回して外し、センサーケーブルをセンサーから切り離してください。

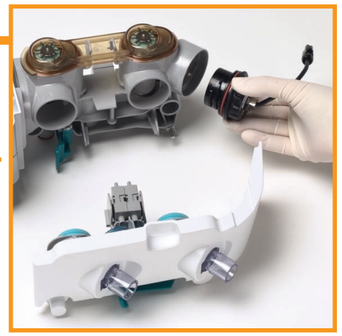

5

フローセンサーケースの蝶ネジを完全に緩めてください。

カバーを引いて外してください。

フローセンサーを取り外してください。

6

呼吸回路モジュールを反時計回りに回して、二つのセクションを引っ張って離してください。

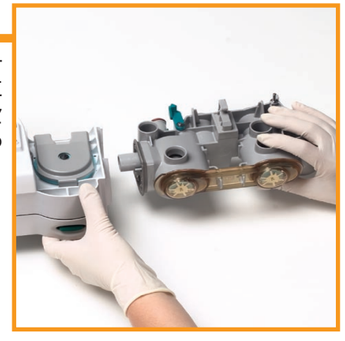

7

EZchange カニスタとコンデンサがある場合の分解。

コンデンサの周囲からガスケットのリップを引き離してコンデンサのリザーバを外します。

8

EZchange カニスタとコンデンサがない場合の分解。

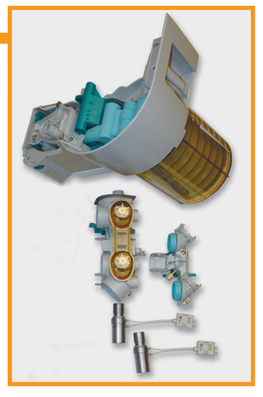

⚠ ISO 17664 に完全に適合した清掃方法については、「クリーニングと滅菌」ユーザーリファレンスマニュアルを参照してください。

⚠ O_2 センサー、センサーケーブル、およびディスポーザブル型フローセンサーはオートクレーブができません。

Datex-Ohmeda, Inc.
P.O. Box 7550
Madison, WI 53707-7550
USA

www.gehealthcare.com

© 2010 General Electric Company – All rights reserved.
GE and GE Monogram are trademarks of
General Electric Company.

Datex-Ohmeda, Inc., a General Electric company,
doing business as GE Healthcare.

1009-0458-000 100 01 10 Translation based on 1009-0395-000 100